

平成26年8月吉日

お得意様各位

東京都港区高輪2-21-38  
大野高輪ビル7F  
株式会社ホリスター  
ダンサック事業部  
マーケティング部  
TEL 0120-977138

## 「X3」・「ソフトコンベックス」 面板の仕様変更について

謹啓 時下ますますご清祥の事とお喜び申し上げます。  
平素は弊社製品に対して格別のご高配を賜り誠に有難うございます。

この度上記ストーマケア製品におきましてお客様の声にお応えすべく面板の仕様変更を致しますので、ご案内申し上げます。今回の変更に伴う製品番号等その他の変更は一切ございません。変更製品は、従来製品の在庫がなくなり次第、順次出荷をさせていただきます。製品により出荷時期が異なりますこと、ご了承賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

製品に関するお問い合わせについては、弊社営業担当者、マーケティング部、およびカスタマーサービス課にて承ります。ダンサックでは、今後とも皆様にご満足いただけますよう努力して参りますので、より一層のご高配を賜ります様、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### 変更点

・面板周囲の透明フィルムを取り除きました。これにより、皮膚保護剤の追従性が増します。

(写真は別紙)

#### 変更開始時期

・平成26年9月出荷製品より順次変更予定  
在庫状況により出荷開始が製品毎で異なる場合がございます。

#### 対象製品

・別紙参照

以上


**\*別紙**

**変更点**

変更前写真

変更後写真

\*こちらのフィルムがなくなります。

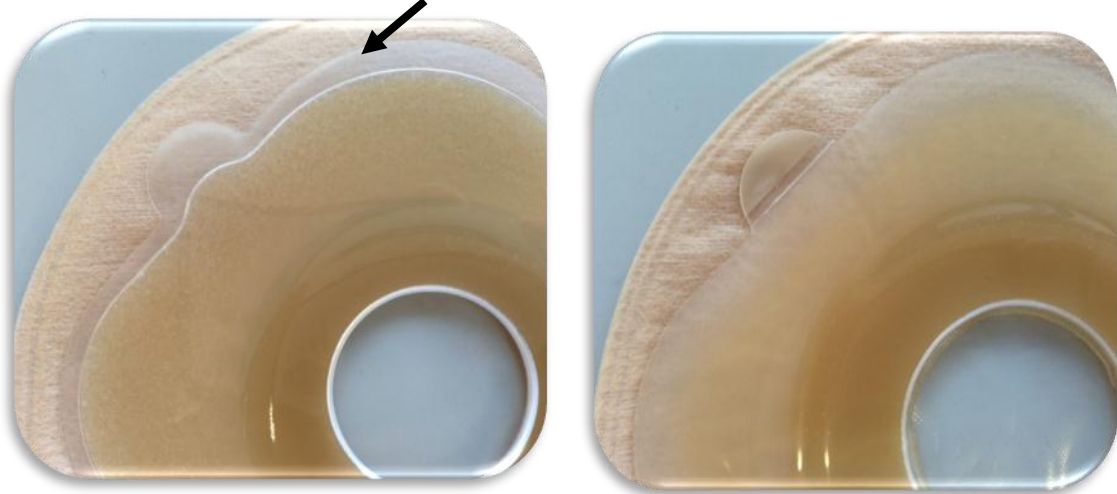

**仕様変更対象製品:**

ノバ1 イレオストミー ソフトコンベックス	820-25. 820-30. 820-35
ノバ1 ウロストミー X3	892-12. 892-20. 892-25. 892-30
ノバ1 フォールドアップ X3	862-15. 862-25. 862-30. 862-35 861-15. 861-25. 861-30. 861-35
ノバ1 フォールドアップ ソフトコンベックス	882-25. 882-30. 882-35 881-25. 881-30. 881-35
ノバ2 X3リング	1343-15. 1343-25. 1355-15. 1355-32. 1355-35
ノバ2 ソフトコンベックス リング	1443-18. 1443-21. 1443-25. 1443-28 1455-32. 1455-35. 1455-38

\*862-40/862-45/882-40/882-45は発売当初よりフィルムは付いておりません。